

人白细胞介素15酶联免疫吸附测定试剂盒

Human IL-15 ELISA Kit

本产品需冰袋运输。保存于4°C，保质期6个月；保存于-20°C，保质期12个月。

产品参数

货号	HJ286
规格	96次
检测范围	46.9 pg/mL~3,000 pg/mL
敏感性	3 pg/mL
特异性	系统和其它因子无交叉反应
样本类型	人血清、血浆、体液、组织匀浆或细胞培养上清

产品简介

本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法检测样品中人 IL-15 的浓度。人 IL-15 捕获抗体已经预包被于酶标板上,当加入样品或标准品时,其中的人 IL-15 会与捕获抗体结合,而其它游离成分则会通过洗涤被除去。接着,再加入生物素标记的人 IL-15 抗体后,抗人 IL-15 抗体与人 IL-15 接合,形成夹心的免疫复合物,其它游离成分则通过洗涤被除去。随后加入酶复合物,生物素与酶复合物特异性结合,这样酶复合物上的 HRP 就与夹心的免疫复合物连接起来,而其它游离成分则通过洗涤被除去。最后加入显色剂,若样品中存在人 IL-15,则会形成免疫复合物,其上连接的 HRP 会催化无色的显色剂氧化生成蓝色物质,而后加入终止液,最终产物呈黄色。通过酶标仪检测,读取 450 nm 处的 OD 值,人 IL-15 浓度与 OD450 值之间呈正比,通过检测标准品绘制标准曲线,对照未知样品中 OD 值,即可计算出样品中人 IL-15 的浓度。

背景简介

白细胞介素15 (Interleukin-15, 简称IL-15) , 是一种由多种细胞 (如活化的单核-巨噬细胞、表皮细胞和成纤维细胞等) 产生的可溶性细胞因子。它属于趋化因子家族, 是白细胞介素的一种, 具有重要的免疫调节功能。

IL-15的分子结构由162个氨基酸组成的前体蛋白, 其中48个氨基酸组成前导序列, 114个氨基酸的成熟IL-15亚基。分子内含有两个二硫键和两个N-连接糖基化位点。人IL-15与猿、小鼠的氨基酸同源性分别是97%和73%。

IL-15具有广泛的免疫调节活性, 能够参与调节多种免疫细胞的存活、增殖与功能, 包括NK细胞、记忆性CD⁸⁺T细胞、NKT细胞等。它对于T细胞具有化学趋化作用, 能够抑制淋巴细胞发生凋亡, 并促进T细胞的活化增殖, 诱导产生细胞毒性T淋巴细胞 (CTL) 。对于CD⁸⁺T细胞, IL-15在维持体内记忆性CD⁸⁺T细胞的数目上起着至关重要的作用。此外, IL-15在DC细胞及巨噬细胞的功能成熟中也扮演重要角色。



产品内容

组分	体积或数量
人IL-15预包被板	8孔条×12个
样品稀释液	30 mL
重组人IL-15标准品(冻干)	2支(10 ng/支)
生物素标记人IL-15抗体	130 μL(效价1:100)
抗体稀释液	12 mL
酶复合物(HRP标记的链霉亲和素)	130 μL(效价1:100)
酶复合物稀释液	12 mL
浓缩洗涤液(25×)	30 mL
显色剂TMB	10 mL
终止液	10 mL
封板胶纸	4张

操作步骤

样品制备

1. 根据样品种类选择相应的处理方法：

- A. 细胞上清：将细胞培养上清液100~500×g离心5 min，去除悬浮物后即可；
- B. 血清样品：将全血在室温下静置0.5~2 h，待其自然凝固并析出血清后，离心取黄色上清即可(4°C, 1,000~2,000×g, 10 min)，注意请勿吸取沉淀，制备好的血清需置于冰上待用，请勿在其中添加任何防腐剂或抗凝剂；
- C. 血浆样品：使用EDTA对全血进行抗凝处理后，混合均匀置于冰上，离心取黄色上清即可(4°C, 1,000~2,000×g, 10 min)，注意请勿吸取沉淀，制备好的血浆需置于冰上待用；
- D. 组织匀浆/体液：离心去除沉淀即可。

注意：① 若待测样品无法及时检测，样品制备完成后，请分装冻存于-20°C，避免反复冻融；

- ② 请保证待测样品清澈透明，检测前如发现样品中有悬浮物，需通过离心去除；
- ③ 为了保证检测结果准确，请勿使用溶血、黄疸、高血脂或污染的样品。

2. 稀释样品

查阅相关文献，预估样品中待测因子的含量，从而确定适当的稀释倍数，使稀释后样品中待测因子的浓度处于ELISA试剂盒的最佳检测范围。根据待测因子含量的不同，分别采取不同的稀释方案：

- ① 待测因子含量在30~300 ng/mL范围内，一般按1:100稀释，即向297 μL样品稀释液中加入3 μL样品；
- ② 待测因子含量在3~30 ng/mL范围内，一般按1:10稀释，即向225 μL样品稀释液中加入25 μL样品；
- ③ 待测因子含量在46.9~3,000 pg/mL范围内，一般按1:2稀释，即向100 μL样品稀释液中加入100 μL样品；
- ④ 待测因子含量<46.9 pg/mL，样品一般无需稀释。

以上方案仅供参考，实验中请详细记录样品的稀释方法。

检测准备工作

3. 试剂盒自 4°C 冰箱取出后,请置于室温平衡 20 min; 如从 -20°C 取出,各组分需彻底融化后再平衡 20 min; 检测完成后,剩余试剂请及时置于 4°C 或 -20°C 保存;
4. 将 **浓缩洗涤液(25×)** 用双蒸水或去离子水稀释成 1× 洗涤液;
5. 重组人 IL-15 标准品的稀释和使用(在使用前 2 h 内准备, 室温操作, **请严格控制在 25~28°C**)
 - ① 配制 10 ng/mL 标准品: 取 1 mL 样品稀释液加入标准品管内, 盖好后静置 15 min 以上, 然后反复颠倒 / 搓动以助溶解;
 - ② 配制 3,000 pg/mL 标准品: 取 300 μL 10 ng/mL 的标准品加入有 700 μL 样品稀释液的 EP 管中, 混匀, 做上标记;
 - ③ 按下表将 3,000 pg/mL 标准品用样品稀释液进行倍比梯度稀释。(最高浓度为 3,000 pg/mL, 将标准品稀释液作为浓度 0 pg/mL。)

管号	稀释液用量(μL)	复溶后标准品用量(μL)	标准品的最终浓度(pg/mL)
A	0	1,000	3,000
B	300	300(从 A 管中取)	1,500
C	300	300(从 B 管中取)	750
D	300	300(从 C 管中取)	375
E	300	300(从 D 管中取)	187.5
F	300	300(从 E 管中取)	93.75
G	300	300(从 F 管中取)	46.88
H	300	0	0

注意: 标准品复溶加样后, 剩余部分请丢弃。

6. 准备生物素标记人 IL-15 抗体工作液
 - ① 按每孔需添加 100 μL 抗体工作液, 计算其总用量(为弥补操作中的损耗, 需多配制 100~200 μL);
 - ② 按 1 μL **生物素标记人 IL-15 抗体** 添加 99 μL **抗体稀释液** 的比例配制工作液, 轻轻混匀。
7. 准备酶复合物工作液(需在使用前 1 h 内准备)
 - ① 按每孔需添加 100 μL 酶复合物工作液, 计算其总用量(为弥补操作中的损耗, 需多配制 100~200 μL);
 - ② 按 1 μL **酶复合物** 添加 99 μL **酶复合物稀释液** 的比例配制工作液, 轻轻混匀。

检测流程

8. 通过计算确定一次实验所需的板条数, 取出所需板条放置于框架内, 多余的板条请放回铝箔袋密封, 保存于 4°C 或 -20°C;
注意: ① **标准品和样品建议做双复孔检测**;
② **每次实验均需绘制标准曲线**。
9. 将用样品稀释液稀释后的样品和不同浓度标准品(100 μL/孔)分别加入相应孔中, 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 孵育 90 min;
注意: ① 请查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度, 若其大于本试剂盒标准曲线的最大标准品浓度, 请将样品适当稀释后再进行检测;
② 整个加样过程不宜超过 10 min, 否则可能会影响检测结果。
10. 甩去酶标板内液体, 无需洗板, 将板倒扣在吸水纸上拍干;
11. 加入稀释后的生物素标记人 IL-15 抗体工作液(100 μL/孔), 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 孵育 60 min;

- 12.**洗板 5 次,每孔 1×洗涤液用量为 300 μL ,注入与吸出间隔 15~30 s,洗完后将板倒扣在吸水纸上拍干;
注意:洗涤过程至关重要,洗涤不充分会导致结果产生较大误差。
- 13.**加入稀释后的酶复合物(100 $\mu\text{L}/\text{孔}$),用封板胶纸封住反应孔,37°C避光孵育 30 min;
- 14.**洗板 5 次,方法同步骤 12;
- 15.**加入 显色剂 TMB(100 $\mu\text{L}/\text{孔}$),用封板胶纸封住反应孔,避光 37°C反应 10~25 min;
注意:① 在保存和使用时,请勿将 TMB 接触氧化剂和金属;
② 因实验室条件差异,最佳显色时间会有所不同,反应充分时肉眼可见标准品的前 3~4 孔有明显的梯度蓝色。
- 16.**加入 终止液(100 $\mu\text{L}/\text{孔}$),混匀后即刻使用酶标仪测量 OD450,同时设定 540 nm 或 570 nm 作为校正波长,即可计算得到校正吸光度值(OD450-OD540 或 OD450-OD570);
注意:读取 OD 值建议在 10 min 内完成。


数据分析

- 17.**绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标,OD 值作纵坐标,利用计算机软件作四参数逻辑(4-PL)曲线拟合创建标准曲线,通过样品的 OD 值即可在标准曲线上计算出其相应浓度。
注意:① 复孔 OD 值在 20% 的差异范围内结果才有效,复孔 OD 值取平均后可作为测量值;
② 若样品 OD 值高于标准曲线上限,应适当稀释后重测,计算浓度时应乘以稀释倍数。

标准曲线范例

人IL-15参考标准曲线

标准品浓度	O.D.
0 pg/mL	0.096
46.88 pg/mL	0.274
93.75 pg/mL	0.366
187.50 pg/mL	0.506
375 pg/mL	0.716
750 pg/mL	1.033
1,500 pg/mL	1.505
3,000 pg/mL	2.202

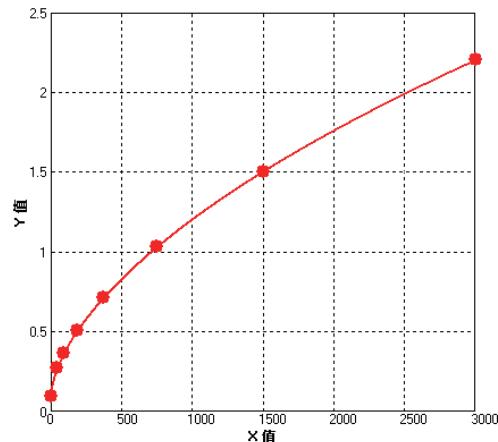

注意:本图仅供参考,应以同次试验标准品所绘标准曲线计算样品含量。

注意事项

- 浓缩洗涤液** 低温情况下可能会出现结晶,请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液;
- 严禁混用不同批号试剂盒的组分;
- 加样过程请避免产生气泡,实验操作过程中一定要保证试剂充分混匀,否则会使结果产生较大误差;
- 说明书中提到的室温条件,请严格控制在25~28°C;
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
- 本产品仅限科研使用。