

大鼠基质金属蛋白酶2酶联免疫吸附测定试剂盒

Rat MMP-2 ELISA Kit

本产品需冰袋运输。保存于4°C，保质期6个月；保存于-20°C，保质期12个月。

产品参数

货号	HJ329
规格	96次
检测范围	0.156 ng/mL~10 ng/mL
敏感性	15 pg/mL
特异性	系统和其它因子无交叉反应
样本类型	大鼠血清、血浆、体液、组织匀浆或细胞培养上清

产品简介

本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法检测样品中大鼠 MMP-2 的浓度。大鼠 MMP-2 捕获抗体已经预包被于酶标板上，当加入样品或标准品时，其中的大鼠 MMP-2 会与捕获抗体结合，而其它游离成分则会通过洗涤被除去。接着，再加入生物素标记的大鼠 MMP-2 抗体后，抗大鼠 MMP-2 抗体与大鼠 MMP-2 接合，形成夹心的免疫复合物，其它游离成分则通过洗涤被除去。随后加入酶复合物，生物素与酶复合物特异性结合，这样酶复合物上的 HRP 就与夹心的免疫复合物连接起来，而其它游离成分则通过洗涤被除去。最后加入显色剂，若样品中存在大鼠 MMP-2，则会形成免疫复合物，其上连接的 HRP 会催化无色的显色剂氧化生成蓝色物质，而后加入终止液，最终产物呈黄色。通过酶标仪检测，读取 450 nm 处的 OD 值，大鼠 MMP-2 浓度与 OD450 值之间呈正比，通过检测标准品绘制标准曲线，对照未知样品中 OD 值，即可计算出样品中大鼠 MMP-2 的浓度。

背景简介

基质金属蛋白酶 2(Matrix Metalloproteinase-2, 简称 MMP-2) 也被称为明胶酶 A(Gelatinase A), 是一种在生物体内广泛分布的酶类, 属于基质金属蛋白酶 (MMPs) 家族的重要成员。它能够降解细胞外基质 (ECM), 参与血管重塑、血管生成、组织修复、肿瘤侵袭、炎症反应和动脉粥样硬化斑块破裂等过程。MMP-2 的功能不仅限于胞外基质蛋白的降解, 它还能作用于一些非基质蛋白, 例如内皮素 1 和 β 型钙钙素基因相关肽 (CGRP)。此外, MMP-2 的 C 端非催化片段 PEX 具有抗血管生成和抗肿瘤特性, 能够抑制细胞迁移, 并减少细胞对碱性成纤维细胞生长因子 FGF2 和玻连蛋白的粘附。

在疾病研究领域, MMP-2 与多种恶性肿瘤的发生和发展密切相关。它在肿瘤细胞的生长、分化、侵袭、转移以及肿瘤血管生成中起到关键作用, 因此成为抗肿瘤治疗的潜在靶点。MMP-2 的表达与癌症患者的临床特征相关, 其表达谱是多种人类疾病的新诊断和预后生物标志物。针对 MMP-2 的抑制剂和药物研究受到广泛关注, 操纵 MMP-2 的表达或功能可能是包括癌症在内的不同疾病的潜在治疗策略。



产品内容

组分	体积或数量
大鼠MMP-2预包被板	8孔条×12个
样品稀释液	30 mL
重组大鼠MMP-2标准品(冻干)	2支(40 ng/支)
生物素标记大鼠MMP-2抗体	130 μ L(效价1:100)
抗体稀释液	12 mL
酶复合物(HRP标记的链霉亲和素)	130 μ L(效价1:100)
酶复合物稀释液	12 mL
浓缩洗涤液(25 \times)	30 mL
显色剂TMB	10 mL
终止液	10 mL
封板胶纸	4张

操作步骤

样品制备

1. 根据样品种类选择相应的处理方法:

- A. **细胞上清**: 将细胞培养上清液100~500 $\times g$ 离心5 min, 去除悬浮物后即可;
- B. **血清样品**: 将全血在室温下静置0.5~2 h, 待其自然凝固并析出血清后, 离心取黄色上清即可(4 $^{\circ}$ C, 1,000~2,000 $\times g$, 10 min), 注意请勿吸取沉淀, 制备好的血清需置于冰上待用, 请勿在其中添加任何防腐剂或抗凝剂;
- C. **血浆样品**: 使用EDTA对全血进行抗凝处理后, 混合均匀置于冰上, 离心取黄色上清即可(4 $^{\circ}$ C, 1,000~2,000 $\times g$, 10 min), 注意请勿吸取沉淀, 制备好的血浆需置于冰上待用;
- D. **组织匀浆/体液**: 离心去除沉淀即可。

注意: ① 若待测样品无法及时检测, 样品制备完成后, 请分装冻存于-20 $^{\circ}$ C, 避免反复冻融;
② 请保证待测样品清澈透明, 检测前如发现样品中有悬浮物, 需通过离心去除;
③ 为了保证检测结果准确, 请勿使用溶血、黄疸、高血脂或污染的样品。

2. 稀释样品

查阅相关文献, 预估样品中待测因子的含量, 从而确定适当的稀释倍数, 使稀释后样品中待测因子的浓度处于 ELISA 试剂盒的最佳检测范围。根据待测因子含量的不同, 分别采取不同的稀释方案:

- ① 待测因子含量在 100~1,000 ng/mL 范围内, 一般按 1:100 稀释, 即向 297 μ L 样品稀释液中加入 3 μ L 样品;
- ② 待测因子含量在 10~100 ng/mL 范围内, 一般按 1:10 稀释, 即向 225 μ L 样品稀释液中加入 25 μ L 样品;
- ③ 待测因子含量在 0.156~10 ng/mL 范围内, 一般按 1:2 稀释, 即向 100 μ L 样品稀释液中加入 100 μ L 样品;
- ④ 待测因子含量 \leq 0.156 ng/mL, 样品一般无需稀释。

以上方案仅供参考, 实验中请详细记录样品的稀释方法。



检测准备工作

3. 试剂盒自 4°C 冰箱取出后,请置于室温平衡 20 min; 如从 -20°C 取出,各组分需彻底融化后再平衡 20 min; 检测完成后,剩余试剂请及时置于 4°C 或 -20°C 保存;
4. 将 **浓缩洗涤液(25×)** 用双蒸水或去离子水稀释成 1× 洗涤液;
5. 重组大鼠 MMP-2 标准品的稀释和使用(在使用前 2 h 内准备, 室温操作, **请严格控制在 25~28°C**)
 - ① 配制 40 ng/mL 标准品: 取 1 mL 样品稀释液加入标准品管内,盖好后静置 15 min 以上,然后反复颠倒 / 搓动以助溶解;
 - ② 配制 10 ng/mL 标准品: 取 250 μ L 40 ng/mL 的标准品加入有 750 μ L 样品稀释液的 EP 管中,混匀,做上标记;
 - ③ 按下表将 10 ng/mL 标准品用样品稀释液进行倍比梯度稀释。(最高浓度为 10 ng/mL,将标准品稀释液作为浓度 0 ng/mL。)

管号	稀释液用量(μ L)	复溶后标准品用量(μ L)	标准品的最终浓度(ng/mL)
A	0	1,000	10
B	300	300(从A管中取)	5
C	300	300(从B管中取)	2.5
D	300	300(从C管中取)	1.25
E	300	300(从D管中取)	0.625
F	300	300(从E管中取)	0.312
G	300	300(从F管中取)	0.156
H	300	0	0

注意: 标准品复溶加样后, 剩余部分请丢弃。

6. 准备生物素标记大鼠 MMP-2 抗体工作液
 - ① 按每孔需添加 100 μ L 抗体工作液,计算其总用量(为弥补操作中的损耗,需多配制 100~200 μ L);
 - ② 按 1 μ L **生物素标记大鼠 MMP-2 抗体** 添加 99 μ L **抗体稀释液** 的比例配制工作液,轻轻混匀。
7. 准备酶复合物工作液(需在使用前 1 h 内准备)
 - ① 按每孔需添加 100 μ L 酶复合物工作液,计算其总用量(为弥补操作中的损耗,需多配制 100~200 μ L);
 - ② 按 1 μ L **酶复合物** 添加 99 μ L **酶复合物稀释液** 的比例配制工作液,轻轻混匀。

检测流程

8. 通过计算确定一次实验所需的板条数,取出所需板条放置于框架内,多余的板条请放回铝箔袋密封,保存于 4°C 或 -20°C;
注意: ① **标准品和样品建议做双复孔检测;**
② **每次实验均需绘制标准曲线。**
9. 将用样品稀释液稀释后的样品和不同浓度标准品(100 μ L/孔)分别加入相应孔中,用封板胶纸封住反应孔,37°C 孵育 90 min;
注意: ① **请查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度,若其大于本试剂盒标准曲线的最大标准品浓度,请将样品适当稀释后再进行检测;**
② **整个加样过程不宜超过 10 min,否则可能会影响检测结果。**
10. 甩去酶标板内液体,无需洗板,将板倒扣在吸水纸上拍干;
11. 加入稀释后的生物素标记大鼠 MMP-2 抗体工作液(100 μ L/孔),用封板胶纸封住反应孔,37°C 孵育 60 min;

12. 洗板 5 次, 每孔 1× 洗涤液用量为 300 μL , 注入与吸出间隔 15~30 s, 洗完后将板倒扣在吸水纸上拍干;
注意: 洗涤过程至关重要, 洗涤不充分会导致结果产生较大误差。
13. 加入稀释后的酶复合物 (100 μL / 孔), 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 避光孵育 30 min;
14. 洗板 5 次, 方法同步骤 12;
15. 加入 显色剂 TMB (100 μL / 孔), 用封板胶纸封住反应孔, 避光 37°C 反应 10~25 min;
注意: ① 在保存和使用时, 请勿将 TMB 接触氧化剂和金属;
② 因实验室条件差异, 最佳显色时间会有所不同, 反应充分时肉眼可见标准品的前 3~4 孔有明显的梯度蓝色。
16. 加入 终止液 (100 μL / 孔), 混匀后即刻使用酶标仪测量 OD450, 同时设定 540 nm 或 570 nm 作为校正波长, 即可计算得到校正吸光度值 (OD450-OD540 或 OD450-OD570);
注意: 读取 OD 值建议在 10 min 内完成。


数据分析

17. 绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标, OD 值作纵坐标, 利用计算机软件作四参数逻辑 (4-PL) 曲线拟合创建标准曲线, 通过样品的 OD 值即可在标准曲线上计算出其相应浓度。
注意: ① 复孔 OD 值在 20% 的差异范围内结果才有效, 复孔 OD 值取平均后可作为测量值;
② 若样品 OD 值高于标准曲线上限, 应适当稀释后重测, 计算浓度时应乘以稀释倍数。

标准曲线范例

大鼠 MMP-2 参考标准曲线

标准品浓度	O.D.
0 ng/mL	0.092
0.156 ng/mL	0.157
0.312 ng/mL	0.233
0.625 ng/mL	0.326
1.25 ng/mL	0.521
2.5 ng/mL	0.91
5 ng/mL	1.418
10 ng/mL	2.166

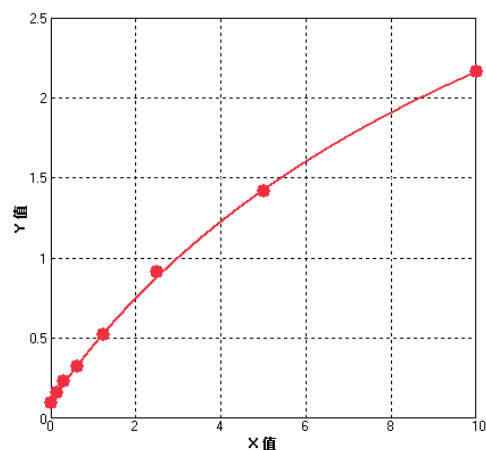

注意: 本图仅供参考, 应以同次试验标准品所绘标准曲线计算样品含量。

注意事项

1. 浓缩洗涤液 低温情况下可能会出现结晶, 请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液;
2. 严禁混用不同批号试剂盒的组分;
3. 加样过程请避免产生气泡, 实验操作过程中一定要保证试剂充分混匀, 否则会使结果产生较大误差;
4. 说明书中提到的室温条件, 请严格控制在 25~28°C;
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
6. 本产品仅限科研使用。